

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 26.01.2016r.

Szp/FZ-64/37/ 2016

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, KOMPUTERÓW, DRUKAREK I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2

Zgodnie z ZWPT - Załącznik nr 6.2 do SIWZ – urządzenie wielofunkcyjne w zestawieniu wymagań w wierszu 22, Zamawiający określa zużycie energii w trakcie kopiowania max. 420W. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, dla którego średnie zużycie w trakcie kopiowania wynosi 580W?

W tym samym punkcie Zamawiający określa typowy pobór mocy prądu (TEC): 2,67 kWh/tydz. Dla proponowanego urządzenia wielkość ta wynosi 2,0 kWh/tydz., co w przypadku akceptacji pozwoli Zamawiającemu na zmniejszenie kosztów związanych z energią jak również uzyskać szerszą gamę korzystnych ofert.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2

Zamawiający za przykład podał urządzenie HP LaserJet Pro 400 M425dn, które jest produktem wycofywanym przed producenta z obrotu.

Czy Zamawiający dopuści nowsze urządzenie HP LaserJet Pro M426fdn MFP, posiadające rozdzielczość kopiarki 600x600 dpiv (tekst w czerni), spełniające pozostałe wymagania określone w OPZ ?


Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1

Przełącznik HP 1910-48G nie jest już produkowany, obecnie HP produkuje jego następcę model 1920-48G. Nowy model jest lepszy, wydajniejszy ale nie spełnia wszystkie parametry poprzednika.

Czy Zamawiający dopuści przełącznik HP 1920-48G o parametrach:

- wielkość pamięci flash 32MB zamiast 128MB
- zakres temperatur (eksploatacja) 0-40C zamiast -45C
- pozostałe parametry są takie same lub lepsze?

Pytanie nr 4

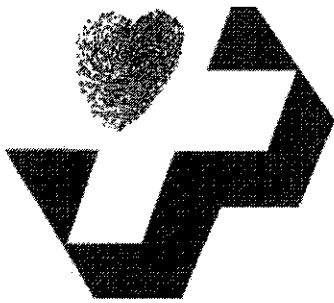

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a

telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

www.wssk.wroc.pl

czy zamawiający w tym postępowaniu dopuści w komputerach stacjonarnych poniższy rozkład portów:

2XPCI

1XPCI-eX1

1XPCI-eX16

I zasilacz 250W

Odpowiedzi

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego TEC jest niższy niż w urządzeniu przykładowym.

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza nowsze urządzenie posiadające rozdzielczość kopiarki 600x600 dpiw (tekst w czerni), spełniające pozostałe wymagania określone w OPZ.

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza nowsze urządzenie posiadające rozdzielczość pamięci flash 32MB i zakres temperatur 0-40C, spełniające pozostałe wymagania określone w OPZ.

Ad. 4 – Zamawiający dopuszcza komputery stacjonarne posiadające zaproponowany rozkład portów.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Edwiga Raziuk