

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 26.01.2016r.

Szp/FZ-64/43/ 2016

### INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, KOMPUTERÓW, DRUKAREK I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity, Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.*), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 1**

Przełącznik HP 1910-48G nie jest już produkowany, obecnie HP produkuje jego następcę model 1920-48G. Nowy model jest lepszy, wydajniejszy ale nie spełnia wszystkie parametry poprzednika.

Czy Zamawiający dopuści przełącznik HP 1920-48G o parametrach:

- wielkość pamięci flash 32MB zamiast 128MB
- zakres temperatur (eksploatacja) 0-40C zamiast -45C
- pozostałe parametry są takie same lub lepsze?

#### **Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 1**

Dotyczy załącznika 6.1 - punkt 7.2 – „procesor wbudowany – ARM” – Czy Zamawiający dopuszcza procesor wbudowany – MIPS?

#### **Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1**

Dotyczy załącznika 6.1 - punkt 7.4 – „Wielkość pamięci flash” – Czy Zamawiający dopuszcza pamięć flash 32 MB?


#### **Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 1**

Dotyczy załącznika 6.1 - punkt 11.1 – „Funkcje zarządzania” – Czy Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania producenta oferowanego przełącznika?

#### **Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w pakiecie nr 3 dopuszczają Państwo urządzenie o następujących parametrach technicznych (pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją) - załącznikiem nr 6.3 do SIWZ:

Prędkość kopiowania i drukowania	55 str./min. (A4), 31 str./min. (A3)
Czas nagrzewania	28 sek.
Standardowa pojemność papieru	4600 arkuszy (1600 + 2000 + 500 + 500) plus podajnik ręczny na 100 arkuszy
Rozdzielczość drukarki	1200 x 1200 dpi (fizyczna)

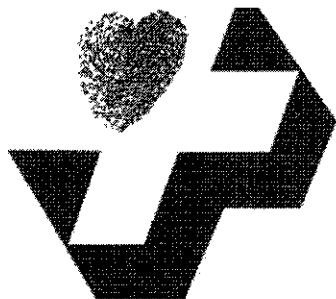

# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a

telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi (fizyczna)
Prędkość skanowania	do 200/160 (mono/kolor) obr./min (300 dpi), z jednoprzebiegowym podajnikiem ADF na 200 arkuszy
Ustawienia drukowania	Uniwersalny sterownik, predefiniowane szablony drukowania, wtyczki (plug-in) do sterownika, wydruk wstrzymany, wydruk z USB
Formaty plików skanera	JPEG, TIFF/ XPS/ PDF jedno i wielostronicowy, zabezpieczony PDF (Secure PDF), skompresowany PDF (Slim PDF), przeszukiwalny PDF (i inne edytowalne formaty jak RTF, TXT)1), PDF/A
Funkcje skanowania	Skanowanie do USB, Skanowanie do e-mail, Skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokalnie), Skanowanie Web Services (push/pull), Skanowanie na skrzynkę, Skanowanie z Metadanymi 1), TWAIN 1.7/ 1.8/ 1.9

### **Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści obudowę SFF, spełniając pozostałe wymagania Zamawiającego określone w OPZ?

### **Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz 250 W lub 300 W, spełniając pozostałe wymagania Zamawiającego określone w OPZ?

### **Odpowiedzi**

**Ad. 5 – Zamawiający dopuszcza nowsze urządzenie posiadające rozdzielczość pamięci flash 32MB i zakres temperatur 0-40C, spełniające pozostałe wymagania określone w OPZ.**

**Ad. 6 – Zamawiający dopuszcza nowsze urządzenie posiadające procesor wbudowany MIPS spełniające pozostałe wymagania określone w OPZ.**

**Ad. 7 – Patrz odpowiedź na pytanie 5.**

**Ad. 8 – Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania producenta oferowanego przekąznika.**

**Ad. 9 – Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zaproponowanych w pytaniu.**

**Ad. 10 – Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.**

**Ad. 11 – Zamawiający dopuszcza zasilacz 250W, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w OPZ.**

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*