

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a

telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 29.01.2016r.

Szp/FZ-64/51/ 2016

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, KOMPUTERÓW, DRUKAREK I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164*) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 4

Zamawiający w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych – stacji roboczej w kolumnie „parametry i warunki graniczne” dla wiersza zasilacz” napisał 290 W prosimy o informacje czy należy tę wartość traktować jako minimum czy maksimum tzn. czy oferowany zasilacz musi mieć moc nie mniejszą niż 290 W czy też musi posiadać moc nie większą niż 290W?

Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy

Paragraf 4 pkt. 2 projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w ramach gwarancji będzie odpowiedzialny za błędne działanie kolejnych aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych komputerach? Jeśli tak, prosimy o wymienienie jakie to oprogramowanie.

Pytanie nr 15 – dotyczy projektu umowy

Paragraf 5 pkt. 8 projektu umowy


Prosimy o wyjaśnienie kto ma być autorem oświadczenia dotyczącego obsługi serwisowej, o której jest mowa w tym punkcie. Czy ma być nim wykonawca czy producent sprzętu, który nie jest uczestnikiem postępowania?

Pytanie nr 16 – dotyczy projektu umowy

Paragraf 8 pkt. 1 projektu umowy.

Z uwagi na bardzo wysokie kary umowne, nie przystające do wagi ani wartości przedmiotu zamówienia, a tym bardziej do warunków rynkowych, wnosimy o ich obniżenie do następujących wartości:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
- 2) (proponujemy usunąć)

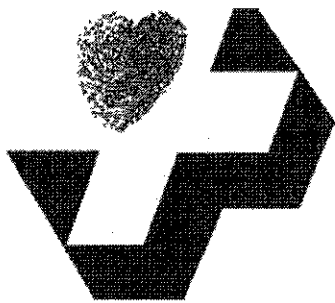

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

- 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy;
- 4) za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 0,5% wartości brutto pakietu za każdy dzień zwłoki

Jednocześnie proponujemy usunięcie obecnego pkt 2) o treści „za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”, ponieważ dotyczy on tej samej kwestii co pkt. 4), a skutkuje inną wysokością kary umownej, co wprowadza niepotrzebne zamieszanie.

Pytanie nr 17 – dotyczy projektu umowy

Paragraf 10 pkt. 3 projektu umowy.

Prosimy o zdefiniowanie pojęcia ‘uchylanie się’.

W jakiej sytuacji zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego uznania działania Wykonawcy jako uchylanie się od zapisów paragrafu 4 pkt. 3 i 5 niniejszej umowy?

Pytanie nr 18 – dotyczy projektu umowy

Paragraf 10 pkt. 4 projektu umowy.

Po jakim czasie od wezwania Zamawiający może odstąpić od umowy, bo z obecnego zapisu wynika, że równocześnie z wysłaniem wezwania, co jest nielogiczne?

Pytanie nr 19 – dotyczy pakietu nr 4

W zestawieniu wymaganych parametrów technicznych będących załącznikiem nr 6.4 do SIWZ Zamawiający wymaga komputery – stacje robocze wyposażone w zasilacz 290W.


25.10.2012r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 14.11.2012r. Dyrektywa ta wprowadza na państwa członkowskie wymóg obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej w UE. Producenci markowego sprzętu przystosowali aktualnie produkowane modele komputerów do wymogów postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ograniczając moc zasilaczy jednocześnie podnosząc ich efektywność. Czy Zamawiający zaakceptuje komputery – stacje robocze wyposażone w zasilacze 250 W, które posiadają wystarczający zapas mocy?

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 4

W zestawieniu wymaganych parametrów technicznych będących załącznikiem nr 6.4 do SIWZ Zamawiający wymaga komputery – stacje robocze wyposażone w złącze HDMI.

Producenci markowego sprzętu zastępują złącze HDMI nowszym rozwiązaniem w postaci złącza DisplayPort. Cyfrowy interfejs DisplayPort jest znacznie szybszym rozwiązaniem i jest w pełni kompatybilny ze starszymi rozwiązaniami co umożliwia zastosowanie przejściówki z DisplayPort na HDMI.

Czy Zamawiający zaakceptuje komputery – stacje robocze wyposażone w złącze DisplayPort?

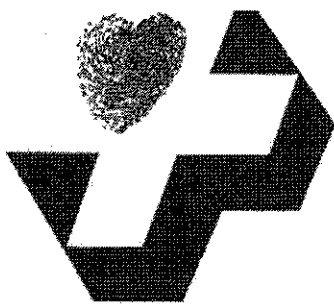

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a

telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

www.wssk.wroc.pl

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający poprawnie określił kwoty wymaganego wadium dla poszczególnych ofert częściowych? Zdaniem Oferenta kwoty wadium są nieproporcjonalne do szacunkowej wartości oferty dla części pakietów.

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w obudowie koloru szarego - taki kolor obudowy posiada następcą (HP 1920-48G) wycofanego modelu (HP 1910-48G)?

Pytanie nr 23 – dotyczy pakietu nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użył określenia "Urządzenie wielofunkcyjne (...) z dodatkowym podajnikiem", natomiast w tabeli przedstawiającej wymagane parametry oferowanego urządzenia jest jedynie zapis "Standardowa pojemność podajników: 300 arkuszy". Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało sumaryczną pojemność podajników papieru na więcej niż 300 arkuszy?

Pytanie nr 24 – dotyczy pakietu nr 4

Zamawiający na str.36 SIWZ, w punkcie: Zasilacz wymaga zasilacza 290W.

Pytanie brzmi: czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym komputer będzie wyposażony w zasilacz o mocy 250W?

Pytanie nr 25 – dotyczy pakietu nr 4

Zamawiający na str.36 SIWZ, w punkcie: Rodzaje wyjść/wejść – panel tylny wymaga złącza HDMI.

Pytanie brzmi: czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym komputer będzie dostarczony z portem cyfrowym DisplayPort wraz z przejściówką na kabel DisplayPort-HDMI?

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający 4 porty USB na tylnym panelu, z czego 2 USB 3.0, spełniający pozostałe zapisy specyfikacji?

Odpowiedzi


Ad. 13 – W opisie przedmiotu zamówienia podana jest moc maksymalna.

Ad. 14 – Zamawiający potwierdza powyższe. Oprogramowanie wbudowane flach, bios, IOS.

Ad. 15 – Autorem oświadczenia ma być Wykonawca, na podstawie informacji od producenta.

Ad. 16

pkt 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie przywołanego punktu.

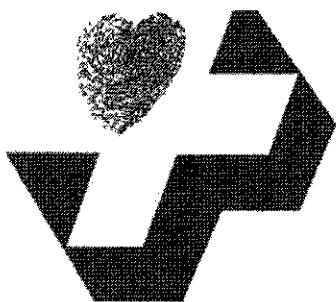

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01

www.wssk.wroc.pl

Pkt 2) zostaje usunięty

Pkt 3) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie przywołanego punktu.

Pkt4) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie przywołanego punktu.

Ad. 17 – poprzez termin „uchylanie się” Zamawiający rozumie nie przestrzeganie przywołanych zapisów.

Ad. 18 – poprzez termin „niezwłocznie” Zamawiający rozumie termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 KC.

Ad. 19 – W opisie przedmiotu zamówienia podana jest moc maksymalna.

Ad. 20 – Zamawiający akceptuje komputery ze złączem DisplayPort.

Ad. 21 – Zamawiający poprawnie określił kwoty wymaganego wadium dla poszczególnych ofert częściowych. Jednocześnie Zamawiający poprawia ilość przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 na 30szt.

Ad. 22 – Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 – informacja nr 1.


Ad. 23 – Łączna pojemność min 300 arkuszy.

Ad. 24 – Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.

Ad. 25 – Patrz odpowiedź na pytanie nr 20.

Ad. 26 – Zamawiający dopuszcza komputer posiadający 4 porty USB na tylnym panelu, z czego 2 USB 3.0, spełniający pozostałe zapisy specyfikacji.

DYREKTOR SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Wilkiewicz