

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 38/44/2018

Wrocław, dnia 05.06.2018 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa stołu operacyjnego oraz kardiomonitorów*”.

Pytanie 1 - Dotyczy wzór umowy §8 pkt 6.

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §8 ust.6:

„wymiany wyrobów medycznych na nowe w przypadku 3 awarii powodującej jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej.”

zapisem:

„wymiany wyrobów medycznych na nowe w przypadku 3 awarii tego samego podzespołu powodującej jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy wzór umowy §11 pkt 1.2.

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §11 ust.1.2.:

„za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia”

zapisem:

„za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu głowy dostępną w odwróconej pozycji pacjenta? W pozycji normalnej regulacja segmentu pod głowę realizowana jest zgodnie z pkt. 26 Załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt. 31

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego z bezszwowymi materacami o właściwościach przeciwoślizgowych o grubości > 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.


Pytanie 5 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podpory pod rękę trzy przegubowej, regulowanej jedną centralną dźwignią dającą możliwość płynnej regulacji w poziomie, pionie oraz na boki z elementem podpierającym przedramię na długości 450 mm, co jest wystarczającą długością biorąc pod uwagę anatomię człowieka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt. 2, 4, 5 i 6


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w postawę na dużych kołach umożliwiającą wsunięcie nóg operatora w przestrzeń podstawy. Wyposażona w 4 podwójne koła obrotowe fi 125 mm z centralną blokadą oraz w blokadę jazdy na wprost. Blokada uruchamiana dźwignią nożną. Stół bez dodatkowego piątego koła kierunkowego – dotyczy l.p. 2, 4, 5, 6. Poniżej przedstawiona wizualizacja podstawy.

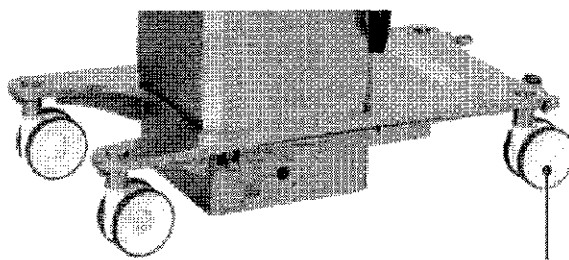

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem – dotyczy l.p. 9

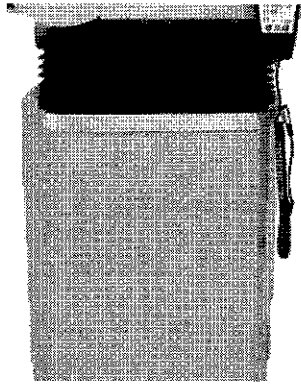

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez funkcji opisanej w punkcie 19? Konstrukcja oferowanego stołu umożliwiła uzyskanie bezpiecznych i płynnych ruchów funkcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji pleców -35° do $+75^{\circ}$? – dotyczy l.p. 21

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z zakresem regulacji pleców -35° do $+75^{\circ}$. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o masie 250 kg? – dotyczy l.p. 22

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 - Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ - pkt 29 i 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym 275kg oraz statycznym 450 kg? – dotyczy l.p. 29, 30

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(5)

*Jacek
Jankowski*