



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefon: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 42/ 569/2020

Wrocław, dnia 09.09.2020 r.


INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej*”.

Pytanie nr 1 - zadanie nr 9 - Rotor kończyn górnych - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści w zapytaniu ofertowym przetargu wysokiej klasy urządzenie rotor: ROTOR MOTomed do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych produkcji niemieckiej z biofeedbackiem, które w swoim wyposażeniu nie posiada uchwytu na butelkę (pkt. nr 20 parametry techniczno-użytkowe).

Pozostałe wyszczególnione parametry urządzenie spełnia w 100 procentach a w niektórych punktach wymaganych parametrów posiada dużo więcej możliwości treningowo terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych.

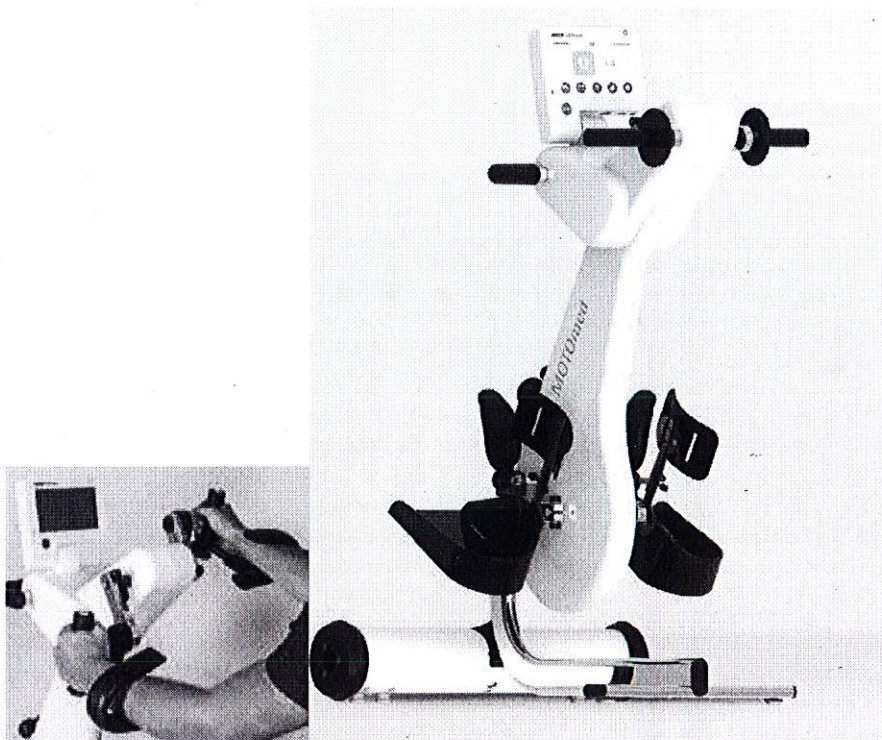

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rotora kończyn górnych bez uchwytu na butelkę. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Jacek
Kowalski*